

## アンスペクトコーワ SARS-CoV-2を ご利用される皆様、介助者・保護者の皆様へ

⚠️ アンスペクトコーワは、唾液採取用滅菌容器は  
同梱しておりません。  
唾液を採取する際は、綿棒を直接口に含んで  
採取する方法(ロリポップ方式)を推奨しています。

⚠️ 唾液を採取する**30分前**から飲食、喫煙、  
歯磨き、口内洗浄はお控えください。



販売元：興和株式会社

## アンスペクトコーワ SARS-CoV-2を ご利用される皆様、介助者・保護者の皆様へ

⚠️ アンスペクトコーワは、唾液採取用滅菌容器は  
同梱しておりません。  
唾液を採取する際は、綿棒を直接口に含んで  
採取する方法(ロリポップ方式)を推奨しています。

⚠️ 唾液を採取する**30分前**から飲食、喫煙、  
歯磨き、口内洗浄はお控えください。



販売元：興和株式会社

## アンスペクトコーワ SARS-CoV-2を ご利用される皆様、介助者・保護者の皆様へ

⚠️ アンスペクトコーワは、唾液採取用滅菌容器は  
同梱しておりません。  
唾液を採取する際は、綿棒を直接口に含んで  
採取する方法(ロリポップ方式)を推奨しています。

⚠️ 唾液を採取する**30分前**から飲食、喫煙、  
歯磨き、口内洗浄はお控えください。



販売元：興和株式会社

## アンスペクトコーワ SARS-CoV-2を ご利用される皆様、介助者・保護者の皆様へ

⚠️ アンスペクトコーワは、唾液採取用滅菌容器は  
同梱しておりません。  
唾液を採取する際は、綿棒を直接口に含んで  
採取する方法(ロリポップ方式)を推奨しています。


⚠️ 唾液を採取する**30分前**から飲食、喫煙、  
歯磨き、口内洗浄はお控えください。




販売元：興和株式会社

## アンスペクトュー SARS-CoV-2を ご利用される皆様、介助者・保護者の皆様へ

- ⚠ 唾液を採取する際は、舌の先を上あごに押し付け、唾液を下あごに溜めて綿棒を浸します。  
綿棒を最低40秒間浸した後、5回以上回転させて充分唾液を含ませてください。

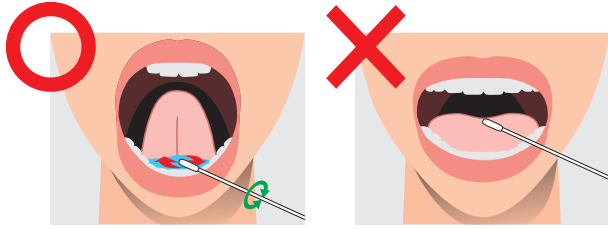


- ⚠ 綿棒で採取した唾液がより多くチューブ内に残るようにしてください。

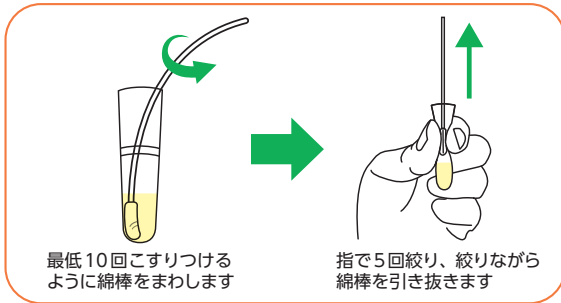


販売元：興和株式会社

## アンスペクトュー SARS-CoV-2を ご利用される皆様、介助者・保護者の皆様へ

- ⚠ 唾液を採取する際は、舌の先を上あごに押し付け、唾液を下あごに溜めて綿棒を浸します。  
綿棒を最低40秒間浸した後、5回以上回転させて充分唾液を含ませてください。

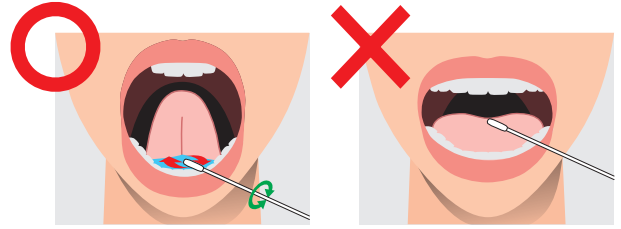


- ⚠ 綿棒で採取した唾液がより多くチューブ内に残るようにしてください。

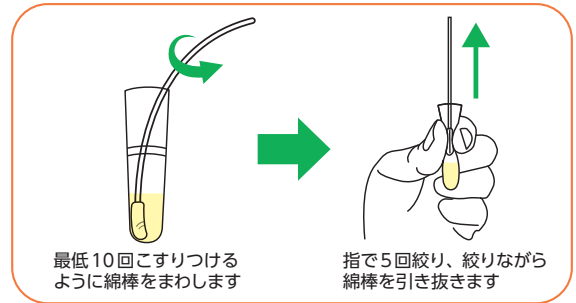


販売元：興和株式会社

## アンスペクトュー SARS-CoV-2を ご利用される皆様、介助者・保護者の皆様へ

- ⚠ 唾液を採取する際は、舌の先を上あごに押し付け、唾液を下あごに溜めて綿棒を浸します。  
綿棒を最低40秒間浸した後、5回以上回転させて充分唾液を含ませてください。

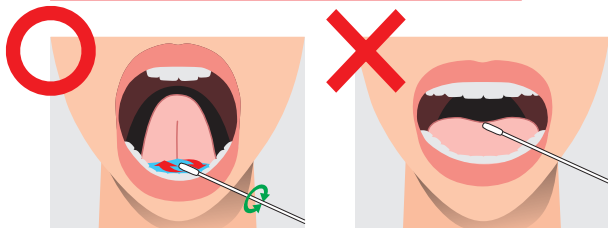


- ⚠ 綿棒で採取した唾液がより多くチューブ内に残るようにしてください。

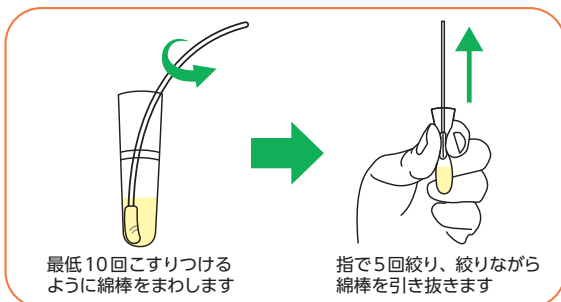


販売元：興和株式会社

## アンスペクトュー SARS-CoV-2を ご利用される皆様、介助者・保護者の皆様へ

- ⚠ 唾液を採取する際は、舌の先を上あごに押し付け、唾液を下あごに溜めて綿棒を浸します。  
綿棒を最低40秒間浸した後、5回以上回転させて充分唾液を含ませてください。

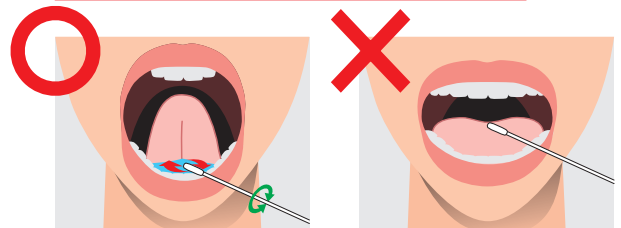

- ⚠ 綿棒で採取した唾液がより多くチューブ内に残るようにしてください。

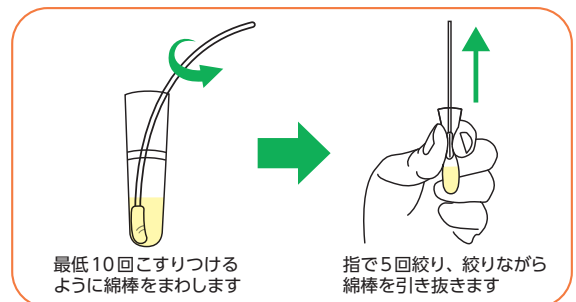

販売元：興和株式会社